

- 扩张矫形器用于椎体撑开，形成一个中空的、可供充填物填充的一个工作空间，恢复部分椎体高度。

扩张矫形器

规格 (mm) $\Phi 3.4 \times 190$

· 刻度标记示意



初始位置





扩张极限位置



逃逸回缩位置

· 操作示意

原位撑开、回缩，手柄每次旋转约 30° ，重复操作不低于6次。

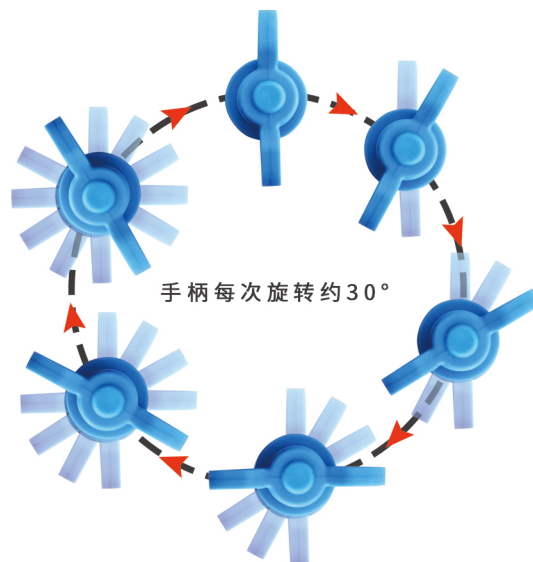

特别注意：叶片撑开后不能旋转，必须等到叶片收回后才能转动。

